
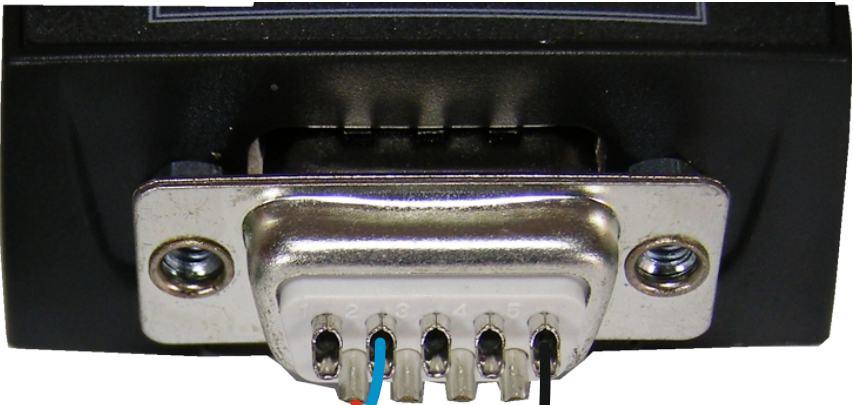


Montage 4404 / DS457

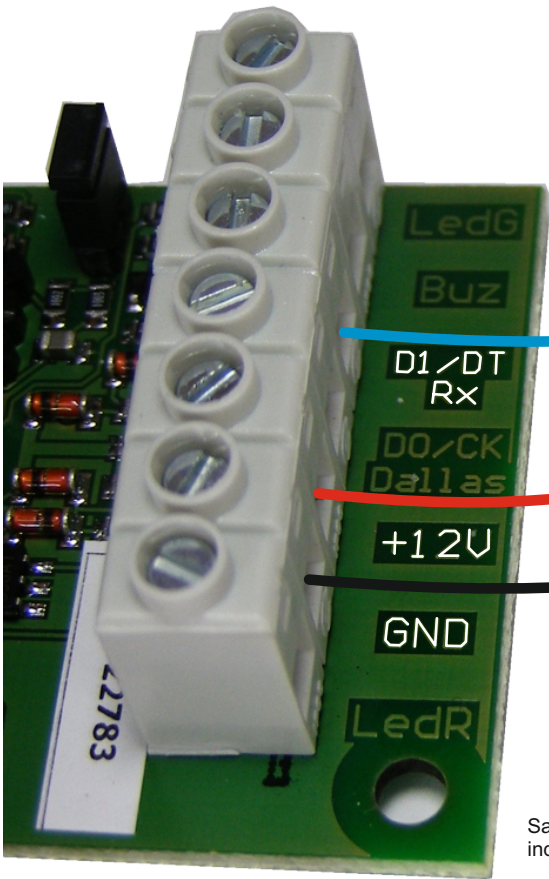


2=Tx
5=Gnd
6=+12V

Indlæs disse stregkode for brug.

<DATA> <SUFFIX 1>
(01h)

Do Not Check For Received Errors

*Standard RS-232

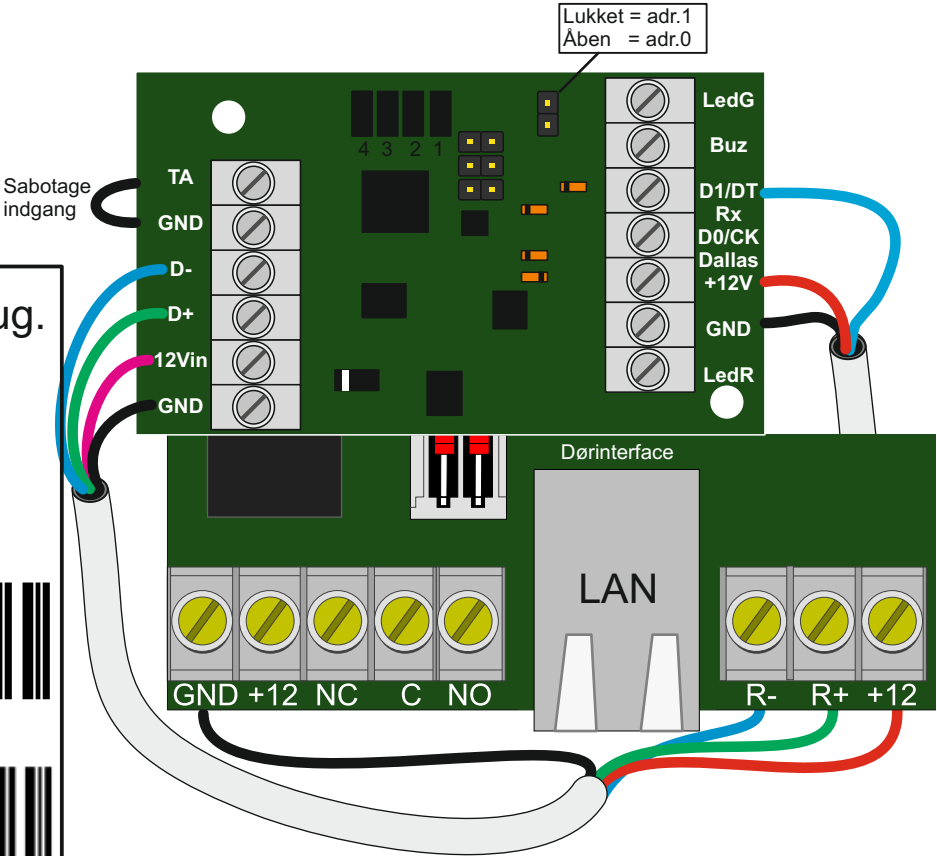

1234567890

Eksempel på kode 39
Husk at starte og afslutte med *
på kode 39
(sundhedkortet er kode 128b)
I forbindelse med dinpark skal
serial port 4 & 9 kortsluttes ved
udprinting.

